

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач учреждения  
здравоохранения «6-я центральная  
районная клиническая поликлиника»

Е.М.Пуцило

« \_\_\_\_\_ »

2025.



**Техническое задание на закупку диатермокоагулятора  
стоматологического 1 (одна) единица  
для комплектации объекта строящегося «Строительство детской  
поликлиники в микрорайоне Лошица-9 на 480 посещений в смену»**

**1. Состав оборудования (из расчета на один комплект):**

№ п/п	Состав (комплектация оборудования)	Количество
1.1.	Блок коагулятора	1
1.2.	Электродержатель с цангой	1
1.3.	Комплект насадок	2

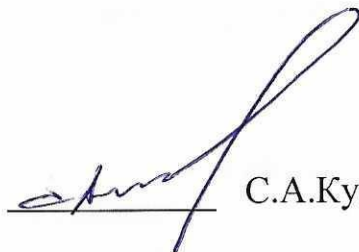
**2. Технические характеристики:**

№ п/п	Наименование	Базовые характеристики
2.1.	Частота генерируемых колебаний, кГц	1750-1800
2.2.	Выходная мощность, Вт	5-7
2.3.	Питание от сети напряжение, В частота, Гц	переменный однофазный 220-230 50-60
2.4.	Потребляемая мощность, Вт	50-65
2.5.	Комплект насадок:	
2.5.1.	Нож	наличие
2.5.2.	Шар	наличие
2.5.3.	Игла	наличие
2.5.4.	Конус	наличие
2.5.5.	петля	наличие

3. Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента ввода медицинской техники в эксплуатацию

Разработчики технических требований:

Председатель комиссии  
по разработке технических характеристик  
МИ: главный внештатный стоматолог  
комитета по здравоохранению  
Мингорисполкома  
(главный врач учреждения здравоохранения  
«14-я городская стоматологическая  
поликлиника»)

  
С.А.Кулик

Члены комиссии:


Главный врач учреждения здравоохранения  
«13-я городская стоматологическая  
поликлиника»

  
Е.Ф.Серафимович

Заместитель главного врача по  
медицинской экспертизе и реабилитации  
учреждения здравоохранения  
«7-я городская стоматологическая  
поликлиника»

  
А.Н.Малевич

Директор КУП «Клиника эстетической  
стоматологии»

  
В.А.Крупенченков